

证书

由 airmid healthgroup 独立测试



airmidhealthgroup.com

ASCR092286v3 报告概述了以下产品已经通过 airmid healthgroup ltd 的测试

产品型号
制造商
证书编号
证书有效期
测试方法概要

AC2726(KJ300F-B11) 同 FY1417


Philips

AHGC: 92286/18/2106/33

04/07/2022

雾化菌进入28.5 立方米环境测试室后，测定去除甲型流感病毒（H1N1）的效率。该设备在测试期间以最高速度运行

飞利浦空气净化器 AC2726(KJ300F-B11) 在 30 分钟运行期内除去空气中 99.9% 以上的甲型流感病毒

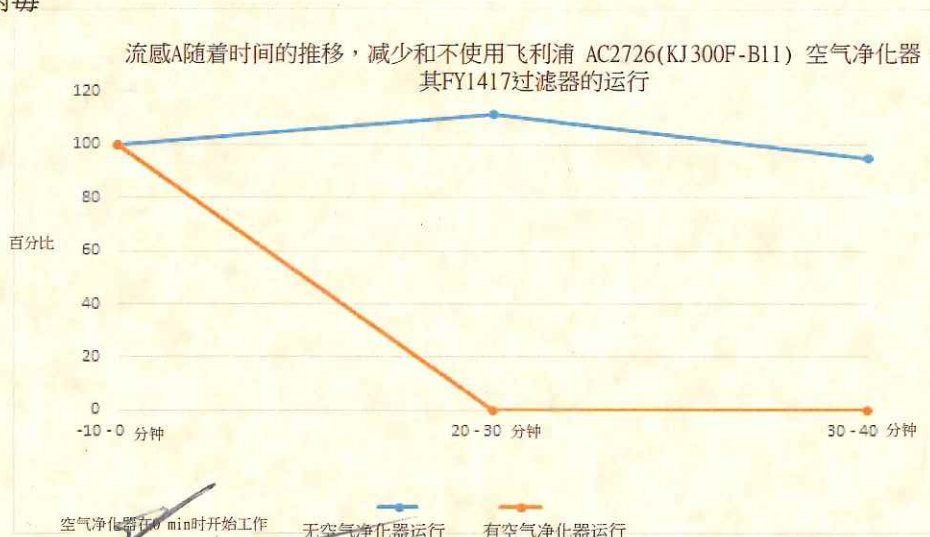

Dr Bruce Mitchell
总裁/首席执行官
airmid healthgroup Ltd

01/08/2018

日期

